








 <p><b>LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983</b></p> <p><b>Access</b></p>	<b>CACHET, VISA &amp; DATE</b>	<b>DATE D'ENVOI</b>	<b>GAMME</b>
		<b>PATIENT</b>	<input type="checkbox"/> <b>Premium*</b> <input type="checkbox"/> <b>Universelle</b>
		Code patient : .....	

En cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au verso


<b>PROTHÈSE CONJOINTE</b>	<b>DENTS CONCERNÉES</b>
---------------------------	-------------------------

<input type="checkbox"/> Couronne céramo-métal / Armature / Finition* ..... <input type="checkbox"/> Couronne Full Zirconia ..... <input type="checkbox"/> Couronne céramique Zircon / Armature / Finition* ..... <input type="checkbox"/> Couronne céramique e.max® / Facette / Inlay ..... <input type="checkbox"/> Couronne métallique / Taquet / Ailette ..... <input type="checkbox"/> Inlay / Onlay composite / Provisoire résine ..... <input type="checkbox"/> Inlay-Core / Opacifié / Clavette / Richmond ..... <input type="checkbox"/> Implant, référence (type d'implant, marque, diamètre) ..... <input type="checkbox"/> Clé de repositionnement ..... <input type="checkbox"/> Attachement, type : .....	
--	--

<b>MÉTAL</b>	<b>EMBRASURE</b>	<b>FORME INTER</b>	<b>POURTOUR CERVICAL</b>
--------------	------------------	--------------------	--------------------------


<input type="checkbox"/> Non Précieux Sans Nickel* <input type="checkbox"/> Semi Précieux <input type="checkbox"/> Précieux	<input type="checkbox"/> Ouverte* <input type="checkbox"/> Fermée	1  3  2  5  4 	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> *  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> Épaulement céramique
<b>DENTS À SOLIDARISER</b>			
Haut <table border="1" style="width:100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"></table>			
Bas <table border="1" style="width:100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"></table>			

<b>SI MANQUE DE PLACE</b>	<b>TEINTE</b>	<b>VOTRE MOIGNON</b>
---------------------------	---------------	----------------------

<input type="checkbox"/> Retouche préparation <input type="checkbox"/> Antagoniste <input type="checkbox"/> Îlot zircon / métallique <input type="checkbox"/> Appeler le praticien*	 Teinte.....	<input type="checkbox"/> Faux moignon <input type="checkbox"/> Dent vivante <input type="checkbox"/> Dyschromié
--	---	---

<b>PROTHÈSE ADJOINTE</b>	
--------------------------	--

<input type="checkbox"/> Cire : Haut / Bas / Base dure <input type="checkbox"/> P.E.I / Haut / Bas / Ciel ouvert <input type="checkbox"/> Châssis : Haut / Bas / Montage / Finition / Finition FlexiVia® / Ackers <input type="checkbox"/> Châssis PEEK : Haut / Bas / Montage / Finition FlexiVia® / Ackers N° du design de châssis choisi (cf. différents designs au verso) : ..... <input type="checkbox"/> Complet / Partiel Résine / Haut / Bas / Montage / Finition <input type="checkbox"/> FlexiVia® / Haut / Bas / Montage / Finition / Ackers <input type="checkbox"/> Teinte du Flexivia® <input type="checkbox"/> Pink* <input type="checkbox"/> Meharry <input type="checkbox"/> Crochets esthétiques acétal sur ..... <input type="checkbox"/> Gouttière de Blanchiment : Haut / Bas <input type="checkbox"/> Plq surélévation <input type="checkbox"/> Gouttière de désocclusion : Haut / Bas* A-Dure (résine)* / B-3 mm Souple et Rigide / C-2 mm Souple / D-1 mm Dure / E-3 mm Souple <input type="checkbox"/> Rebasage / Réparation / Adjonction dent / crochet	Nombre de dents : Haut : ..... Bas : ..... Crochets sur : .....
--	--

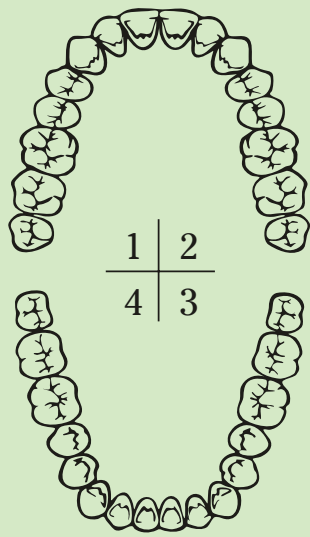

<b>OBSERVATIONS</b>	
---------------------	--

	<input type="checkbox"/> Appeler avant de démarrer la réalisation <input type="checkbox"/> Appeler après coulée des modèles
RDV Patient : Date ..... / ..... / ..... Heure .....	
<b>FOURNITURES SOUHAITÉES</b>	
<input type="checkbox"/> Fiches de laboratoire <input type="checkbox"/> Etiquettes Nom Praticien <input type="checkbox"/> Boîtes <input type="checkbox"/> Sachets kangourou <input type="checkbox"/> Etiquettes transport <input type="checkbox"/> Sachets transporteur <input type="checkbox"/> Autre : .....	

<b>ÉLÉMENTS JOINTS À LA COMMANDE</b>	
--------------------------------------	--


<input type="checkbox"/> Nbr d'empreintes : ..... <input type="checkbox"/> Modèle <input type="checkbox"/> Mordu <input type="checkbox"/> Transfert <input type="checkbox"/> Analogue <input type="checkbox"/> Pilier <input type="checkbox"/> Autre : .....	
--	--

<b>ÉLÉMENTS ENVOYÉS PAR MAIL</b>	
----------------------------------	--

E-mail : labo.access@crownceram.com - Merci de mentionner le code du patient et le n° de la fiche de laboratoire. <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> Photo <input type="checkbox"/> Autre : .....	
---	--

CC-ACCESS-FLV-2022-V1  
Crown Ceram - Sari au capital de 7622,45 € - Siret 329 790 000 00064 - NAF 3250 A - RCS Mulhouse T1:329 790 000 - Lieu de juridiction : Mulhouse.

# NOS DIFFÉRENTS DESIGNS DE CHÂSSIS

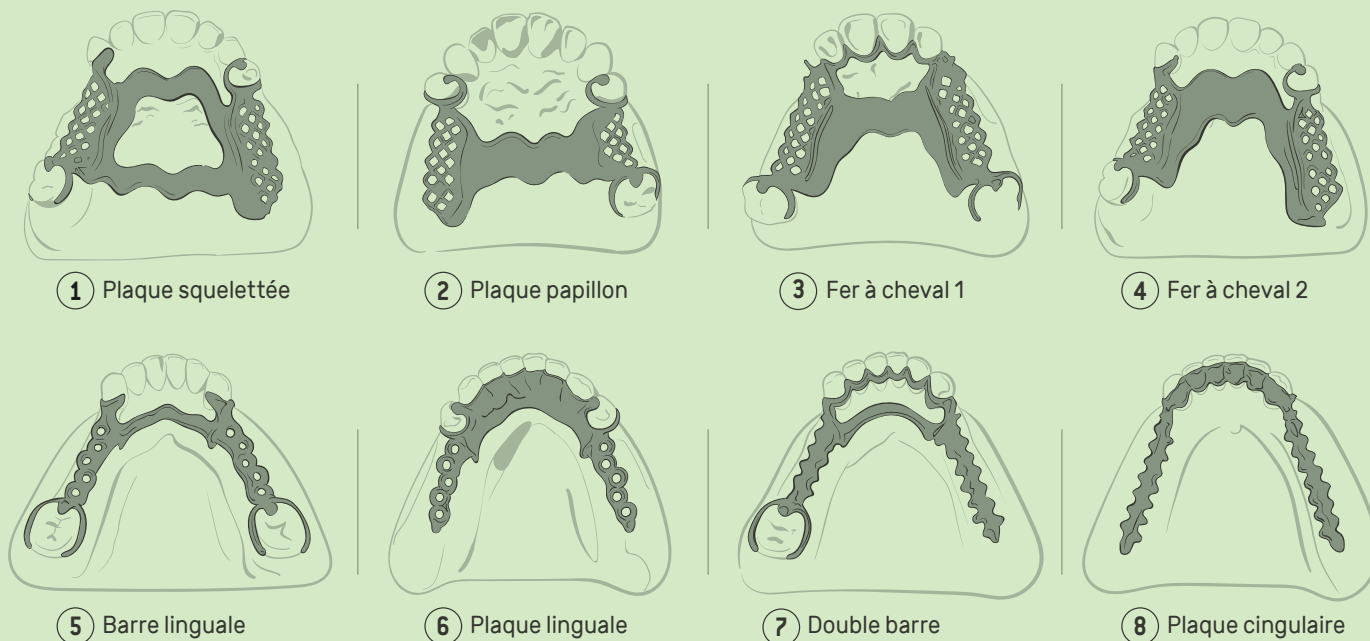

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Dès lors qu'une empreinte accompagnée de la fiche de laboratoire est envoyée au laboratoire Crown Ceram, le client reconnaît avoir pris connaissance, compris et accepté les conditions générales de vente énoncées ci-dessous.

### 1. PRISE DE COMMANDE

- Toute commande doit être réalisée par le biais de la fiche de laboratoire Crown Ceram dûment complétée et d'une empreinte soigneusement réalisée.
- Le client est responsable de la désinfection des empreintes pour éliminer les micro-organismes qui y sont appliqués avant expédition au laboratoire Crown Ceram.
- Le client est responsable de la qualité de l'empreinte livrée au laboratoire Crown Ceram. Si celle-ci n'est pas réalisée avec soin, le laboratoire Crown Ceram ne peut être tenu pour responsable en cas d'inadéquation de la prothèse en bouche, si celle-ci respecte en tous points la prise d'empreinte livrée à la commande.
- La commande passée est ferme et ne peut donner lieu à une annulation totale ou partielle que si elle intervient dans les 24h suivant sa réception au laboratoire Crown Ceram.
- Toute commande livrée sera considérée comme acceptée.

### 2. CONDITIONS DE VENTE

- Tarifs : les prix applicables, dont le client reconnaît avoir été préalablement informé, sont ceux en vigueur au jour de la passation de la commande.
- Frais de transport : un barème de participation aux frais de transport est mis en place en fonction du type de transport souhaité, de la régularité du ramassage et de la facturation mensuelle.
- Factures : une facture récapitulative des travaux effectués est adressée chaque fin de mois au client, et est payable sous 10 jours.
- Règlements : à défaut de règlement à échéance, l'intégralité des sommes dues au titre des commandes en cours sera immédiatement exigible sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.  
En l'application de l'article L411-6 du Code de commerce, il est prévu que les pénalités de retard ne pourront être inférieures à 3 fois le taux d'intérêt légal et qu'une indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 euros sera appliquée.  
En outre, l'intégralité des sommes restant dues, même non échues, deviendra immédiatement exigible, et ce sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable.
- En application de l'article L441-6 du Code de commerce, il est prévu une indemnité complémentaire de recouvrement qui sera appliquée sur toutes les factures totalement ou partiellement impactées à l'échéance égale à 15% du montant resté impayé.
- Avoirs : aucun avoir ne sera consenti sur les prothèses retournées par le client pour quelque motif que ce soit. En effet dans le cadre de la garantie Crown Ceram, le laboratoire s'engagera à refaire ou à modifier ses travaux prothétiques jusqu'à parfaite adaptation en bouche. Toutefois, si après 3 interventions minimum de sa part en vue de refaire ou de modifier un travail, la prothèse ne s'adaptait pas en bouche, le laboratoire Crown Ceram pourra émettre un avoir à sa clientèle.
- Changement de teinte: tout changement de teinte par rapport à la commande initiale, même dans le cadre d'une réparation ou d'un travail à refaire, sera facturé d'après le tarif du laboratoire Crown Ceram en vigueur.

### 3. MÉTAUX PRÉCIEUX

- Dans le cas de travaux refaits sur des métaux précieux ou semi-précieux, le laboratoire Crown Ceram, sur une base de 20 à 25% de pertes (taux pratiqué par l'ensemble de la profession), pourra après avoir récupéré le travail initial, re-facturer le différentiel par rapport au travail final. La différence se fera lors de la pesée, qui détermine le taux de perte lors de la découpe de la tige de coulée et du grattage, celui-ci permettant un passage de l'état brut à l'état poli.

b. Dans le cas de travaux refaits, après récupération du travail initial, le laboratoire Crown Ceram se réserve la possibilité de refacturer les nouvelles pertes occasionnées.

### 4. GARANTIE

- Les travaux prothétiques réalisés par le laboratoire Crown Ceram sont garantis 5 ans à compter de leur livraison, sauf les prothèses amovibles 1 an hors rebasage et tout type de gouttières 6 mois.
- Aucune garantie ne s'appliquera sur les travaux prothétiques non posés en bouche passé un délai d'1 mois après leur livraison.
- Dans le cadre de la garantie, le laboratoire Crown Ceram s'engage à refaire ou à modifier ses prothèses jusqu'à parfaite adaptation en bouche.
- Aucun avoir ne sera consenti dans le cadre de la garantie, sans retour impératif des travaux défectueux et avec l'accord préalable du laboratoire Crown Ceram.

### 5. LIVRAISON & DÉLAIS

Les délais d'exécution et de livraison des travaux sont donnés au client à titre indicatif.

La responsabilité du laboratoire Crown Ceram ne peut être engagée dans les cas suivants :

- Retard de livraison imputable au transporteur
  - Retard d'exécution ou de livraison dus à des événements fortuits (accident, grève) ou à ces cas de force majeure (intempéries, incendie, catastrophe naturelle)
  - Retard de livraison lorsque la commande a été mal ou insuffisamment libellée par le client
- Tout dépassement de ces délais ne pourra donner lieu ni au versement par le laboratoire Crown Ceram de dommages et intérêts ni à la résiliation de la commande passée par le client.

### 6. PROPRIÉTÉ

En référence à la loi du 12.05.1980 (clause de réserve de propriété), le laboratoire Crown Ceram demeure propriétaire de ses travaux et marchandises vendues, même après livraison, jusqu'à l'intégralité de leur règlement.

### 7. RETOURS

- Dans le cadre d'un retour de travaux défectueux à refaire ou à modifier, le client est invité systématiquement à retourner ces derniers au laboratoire Crown Ceram sur les modèles en plâtre d'origine haut et bas en mentionnant le numéro d'origine de la commande. Dans le cas contraire, le laboratoire Crown Ceram se verra contraint de lui facturer l'ensemble des travaux à nouveau réalisés.
- Toute modification de la nature du travail entraînera une nouvelle facturation des prothèses réalisées.

### 8. LITIGE

Tout litige susceptible de s'élever entre les parties quant à la formation, l'exécution ou l'interprétation de tout ou partie du présent contrat, les parties conviennent expressément que sera seule compétente la Juridiction du tribunal de Mulhouse.

Le droit applicable est le droit français, quelle que soit la nationalité du client.

### 9. ACCEPTATION DU CLIENT

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs et barèmes, sont expressément agréés et acceptés par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.